


## Release Notes R2.11


### Pop-up bij ongelezen nieuwsberichten

Vanaf nu worden nieuwe berichten direct bij het inloggen getoond. Zo blijf je nog beter op de hoogte van de wijzigingen en berichten vanuit het zorgkantoor. Zodra het bericht gelezen is wordt het gemarkeerd en verdwijnt de pop-up. Je kunt er ook voor kiezen hem tijdelijk te sluiten en de volgende keer te lezen.

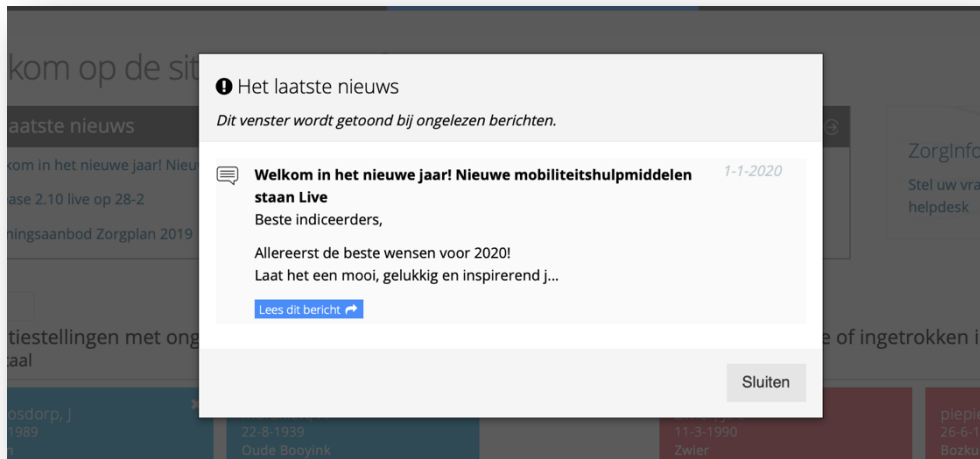

### Inzetrestrictie rolstoel inzetten

Het is niet meer mogelijk om een rolstoel in te zetten als er al twee actieve inzetten zijn. Er zal dan eerst een rolstoel beëindigd moeten worden.

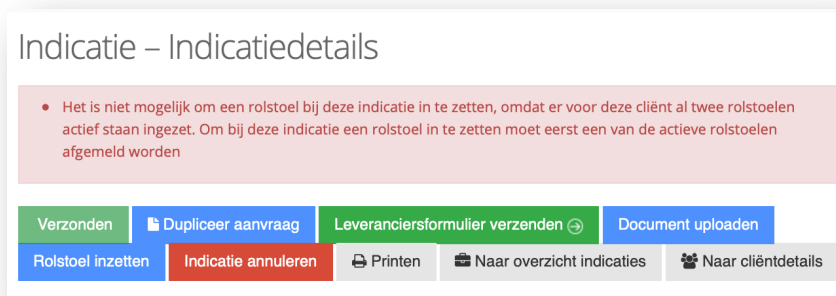

### Actieve monitoring als leveranciersformulier niet aankomt

Het portaal stuurt het leveranciersformulier in veel gevallen automatisch door naar de leverancier en/of dephouder. Als deze mail niet aankomt loopt het proces onnodige en onwenselijke vertraging op. Vanaf release 2.11 wordt er actief gemonitord of de mails aankomen. Dus als er problemen zijn met de ontvangende server of bij een onjuist emailadres, krijg je als indiceerder een bericht vanuit de helpdesk.

## Annulering van originele indicatie bij herstelduplicaat

Bij het maken van een duplicaat krijg je momenteel twee opties;

1. Wijzigen/herstellen
2. Nieuwe (losstaande) indicatie

Als je dupliceert om te herstellen betekent het dat de oorspronkelijke indicatie niet meer juist is. Je wilt namelijk een tweede indicatie indienen die wel volledig klopt. Het portaal zal dan ook vanaf nu de oude indicatie annuleren. Zo weet het zorgkantoor maar ook de leverancier dat er een nieuwe indicatie is en de oude geen vervolg krijgt.

Uiteraard wordt dit bij optie 2 niet gedaan. Hier gebruik je immers alleen de oude informatie om niet alles opnieuw in te hoeven vullen.

### Duplicatiecontrole

Wat is de reden voor het maken van een duplicaat? \*

Ik wil de indicatie herstellen, opnieuw indienen of iets toevoegen/verwijderen

Ik wil een compleet nieuwe indicatie starten op basis van de informatie uit de oude indicatie

Toelichting op het herstellen, wijzigen of aanpassen van een vorige indicatie \*

Toelichting

Werkblad vergeten en verkeerde maat opgegeven

### Let op!

Wanneer u verder gaat met de gekozen optie "Ik wil de indicatie herstellen, opnieuw indienen of iets toevoegen/verwijderen", wordt de oorspronkelijke indicatie waar u van dupliceert geannuleerd of ingetrokken. Wilt u dit niet, kies dan om een nieuwe indicatie te starten op basis van de informatie uit de oude indicatie. Wilt u verder gaan met de huidige keuze?

Ja Nee



Hetzelfde proces is ook geïmplementeerd voor het overnemen van een reservering. Hierbij wordt ook de oude indicatie geannuleerd.

## Maatvoering cliënt tonen bij het herinzetselectie scherm

Zodra je het depot belt is het handig om ook de ingevoerde maatvoering in beeld te hebben. Vanaf nu wordt dit getoond op het herinzetselectie scherm.

Indicatie - Herinzetselectie

Voorschrijver > Vragenlijst > Producteisen > Mogelijke oplossingen > Herinzet

≡ Aanvullende informatie

Producteisen

|                   |                                 |                      |                                 |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Zittingcategorie: | Zittingcategorie I              | Rugleuningcategorie: | Rugleuningcategorie I           |
| Hoofdsteun:       | Geen hoofdsteun                 | Kanteling:           | Geen kantelverstelling          |
| Bekleding:        | Standaard bekleding             | Armsteun links:      | In hoogte verstelbare armlegger |
| Armsteun rechts:  | In hoogte verstelbare armlegger | Werkblad:            | Geen                            |
| Beensteun links:  | Standaard beensteun             | Beensteun rechts:    | Standaard beensteun             |
| Voortbewegen:     | Zelfrijden trippelen            |                      |                                 |

Maatvoering

|                  |       |                  |       |
|------------------|-------|------------------|-------|
| Bovenbeenlengte: | 45 cm | Onderbeenlengte: | 45 cm |
| Heupbreedte:     | 45 cm | Ruglengte:       | 45 cm |

Adequate rolstoelen:

## Veld voor voorlopig poolnummer bij Overname

Vanaf nu is er een invoerveld voor het voorlopig poolnummer bij een overname.

Er wordt een door het systeem voorgestelde rolstoel uit het depot (instelling of centraal) geselecteerd.  
 Er is een rolstoel aanwezig, die het systeem niet aangeeft, maar naar mijn mening wel voldoet.  
 Er is sprake van een overname.

Herkomst overname:
  Uit de WMO  
 Uit een ander zorgkantoor

Voorlopig poolnummer: